

1 - Paramètres des essais

Id. Rapport : Q CF 2248

Date de Vérification : 18/10/2012 17:00:01 Intervenant JP
 Libellé Matériel Contrôlé : Autoclave à vapeur
 Id. Interne Matériel : CF 2248

Client : Test d'application client

Nombre d'enregistreurs : 2 Date / Heure de début : 18/10/12 17:27
 Intervalle de mesure : 0:01:00 Date / Heure de fin : 18/10/12 21:26
 Nombre de mesures : 240

Micro-organisme ciblé :	EF	Unité	°C
Indice de réduction Z :	10	Mesure affichée :	75 <i>(optionnel, sur l'appareil qualifié)</i>
Température de référence	70		°C
Température létale	70		°C
Température Barème	73.8		°C
Durée Barème	82		mn
VP / VS Ciblée			mn

Saisir les paramètres et cliquer sur Mettre à Jour.

Commentaires Foie Gras mi-cuit, 500 boites 200gr en verrines, 73.8 °C, 82 mn

2 - Instruments de Mesure Utilisés

	Id. Interne	Id. Unique Constructeur	Position	Remarque	Date Etalonnage	Modèle	incertit. Appareil
1	TT002	0000001631C241	Sonde amb.		23/09/2011	DS1922T	0.12
2	TT001	0000001D6DB641	Boîte		12/09/2012	DS1922T	0.12
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

3 - Exploitation des Mesures

Barème 82 mn / 73.8 °C

	Position	Montée en régime (mn)	VP/VS montée	Durée régime établi	VP/VS régime établi	Durée refroidis - sement	VP/VS refroidis - sement	VP/VS Totale	Sélection pour Liste VP / VS	T° Maxi atteinte	T° Moyenne Palier
1	Sonde amb.	31.00	9.87	82.00	201.30	0.00	1.26	212.43		74.05	73.95
2	Boîte		0.00		81.29	8.00	17.44	98.74	X	73.70	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											

(cliquer dans la colonne Sélection svp)
 (puis Mettre à jour ...)


VP/ VS Minimale	98.74
VP/ VS Maximale	212.43

4 - Conclusions

Remarques Attention : Corriger affichage , 73.8 °C mesuré po ur 75 °C affiché.

Signature

5 - Représentation Graphique des Mesures

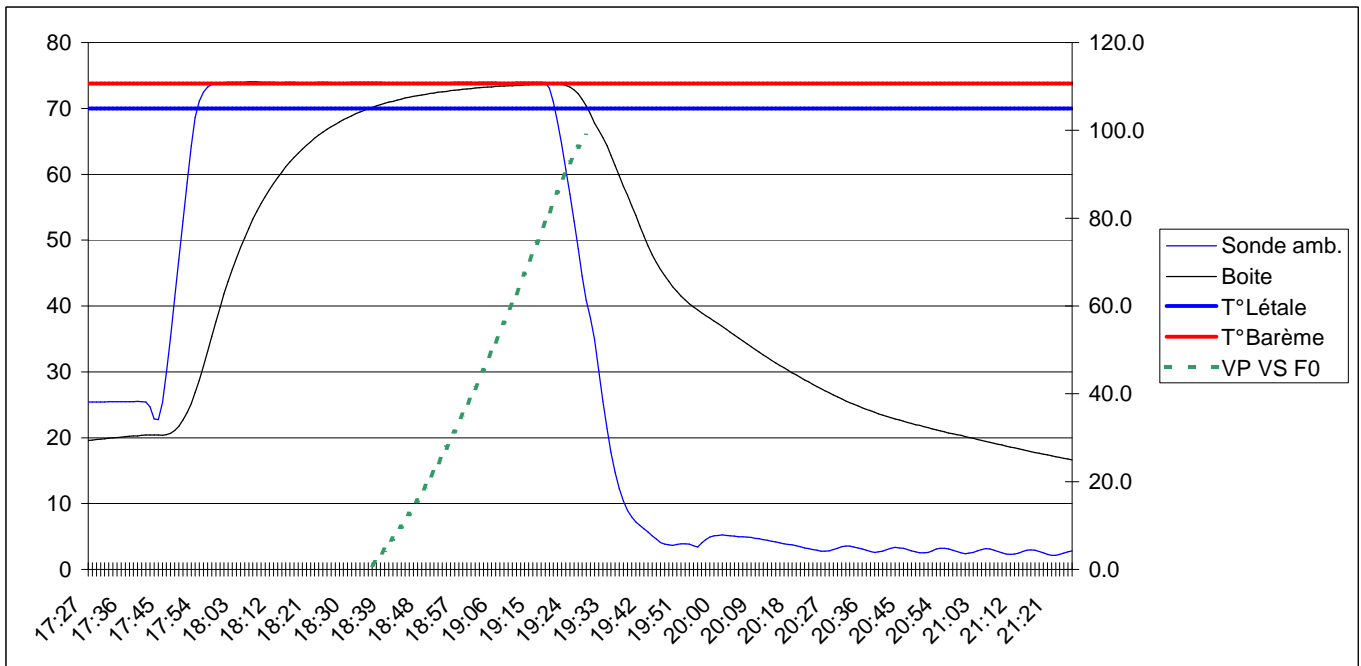

18/10 19:09:01	73.93	73.45	2.213	58.417	72
18/10 19:10:01	73.93	73.45	2.213	60.630	73
18/10 19:11:01	73.99	73.51	2.244	62.874	74
18/10 19:12:01	73.99	73.51	2.244	65.117	75
18/10 19:13:01	73.99	73.57	2.275	67.393	76
18/10 19:14:01	73.99	73.57	2.275	69.668	77
18/10 19:15:01	73.99	73.64	2.312	71.980	78
18/10 19:16:01	73.99	73.64	2.312	74.292	79
18/10 19:17:01	73.99	73.64	2.312	76.604	80
18/10 19:18:01	73.93	73.7	2.344	78.948	81
18/10 19:19:01	73.05	73.7	2.344	81.292	82
18/10 19:20:01	71	73.7	2.344	83.637	83
18/10 19:21:01	68	73.7	2.344	85.981	84
18/10 19:22:01	64.57	73.7	2.344	88.325	85
18/10 19:23:01	60.77	73.51	2.244	90.569	86
18/10 19:24:01	56.95	73.26	2.118	92.687	87
18/10 19:25:01	52.88	72.83	1.919	94.606	88
18/10 19:26:01	48.69	72.2	1.660	96.266	89
18/10 19:27:01	44.55	71.39	1.377	97.643	90
18/10 19:28:01	40.85	70.39	1.094	98.737	91
18/10 19:29:01	38.21	69.14			92
18/10 19:30:01	34.89	67.76			93
18/10 19:31:01	30.18	66.7			94
18/10 19:32:01	25.52	65.58			95
18/10 19:33:01	21.37	64.33			96
18/10 19:34:01	17.78	62.89			97
18/10 19:35:01	14.76	61.32			98
18/10 19:36:01	12.3	59.76			99
18/10 19:37:01	10.41	58.2			100
18/10 19:38:01	8.96	56.82			101
18/10 19:39:01	7.95	55.19			102
18/10 19:40:01	7.19	53.75			
18/10 19:41:01	6.69	52.19			
18/10 19:42:01	6.18	50.62			
18/10 19:43:01	5.68	49.12			
18/10 19:44:01	5.11	47.8			
18/10 19:45:01	4.6	46.61			
18/10 19:46:01	4.1	45.55			
18/10 19:47:01	3.85	44.61			
18/10 19:48:01	3.72	43.73			
18/10 19:49:01	3.66	42.91			
18/10 19:50:01	3.78	42.22			
18/10 19:51:01	3.91	41.53			
18/10 19:52:01	3.91	40.9			
18/10 19:53:01	3.85	40.34			
18/10 19:54:01	3.59	39.84			
18/10 19:55:01	3.4	39.4			
18/10 19:56:01	3.97	38.96			
18/10 19:57:01	4.54	38.52			
18/10 19:58:01	4.92	38.14			
18/10 19:59:01	5.11	37.7			
18/10 20:00:01	5.17	37.33			
18/10 20:01:01	5.23	36.89			
18/10 20:02:01	5.17	36.45			
18/10 20:03:01	5.11	36.01			
18/10 20:04:01	5.04	35.57			
18/10 20:05:01	4.98	35.13			
18/10 20:06:01	4.98	34.69			
18/10 20:07:01	4.92	34.25			
18/10 20:08:01	4.86	33.81			
18/10 20:09:01	4.73	33.37			
18/10 20:10:01	4.67	32.99			
18/10 20:11:01	4.54	32.55			
18/10 20:12:01	4.41	32.17			
18/10 20:13:01	4.29	31.73			
18/10 20:14:01	4.16	31.35			
18/10 20:15:01	4.03	30.98			
18/10 20:16:01	3.91	30.6			
18/10 20:17:01	3.78	30.22			
18/10 20:18:01	3.72	29.85			
18/10 20:19:01	3.59	29.53			
18/10 20:20:01	3.47	29.15			
18/10 20:21:01	3.28	28.78			
18/10 20:22:01	3.15	28.46			
18/10 20:23:01	3.02	28.09			
18/10 20:24:01	2.9	27.77			
18/10 20:25:01	2.77	27.46			
18/10 20:26:01	2.77	27.14			
18/10 20:27:01	2.84	26.83			
18/10 20:28:01	3.02	26.51			
18/10 20:29:01	3.21	26.2			
18/10 20:30:01	3.47	25.89			
18/10 20:31:01	3.53	25.57			
18/10 20:32:01	3.53	25.32			
18/10 20:33:01	3.4	25.07			
18/10 20:34:01	3.28	24.82			
18/10 20:35:01	3.09	24.56			
18/10 20:36:01	2.9	24.31			
18/10 20:37:01	2.71	24.12			
18/10 20:38:01	2.58	23.87			
18/10 20:39:01	2.65	23.62			
18/10 20:40:01	2.77	23.43			
18/10 20:41:01	3.02	23.24			
18/10 20:42:01	3.21	23.05			
18/10 20:43:01	3.34	22.86			
18/10 20:44:01	3.28	22.68			
18/10 20:45:01	3.21	22.49			
18/10 20:46:01	3.02	22.3			
18/10 20:47:01	2.84	22.17			
18/10 20:48:01	2.65	21.98			
18/10 20:49:01	2.52	21.86			
18/10 20:50:01	2.52	21.67			
18/10 20:51:01	2.58	21.54			
18/10 20:52:01	2.84	21.35			
18/10 20:53:01	3.09	21.17			
18/10 20:54:01	3.21	21.04			
18/10 20:55:01	3.21	20.91			

	18/10 20:56:01	3.09	20.72
	18/10 20:57:01	2.9	20.6
	18/10 20:58:01	2.71	20.47
	18/10 20:59:01	2.52	20.35
	18/10 21:00:01	2.39	20.16
	18/10 21:01:01	2.46	20.03
	18/10 21:02:01	2.58	19.91
	18/10 21:03:01	2.84	19.72
	18/10 21:04:01	3.02	19.59
	18/10 21:05:01	3.15	19.46
	18/10 21:06:01	3.09	19.28
	18/10 21:07:01	2.9	19.15
	18/10 21:08:01	2.71	19.02
	18/10 21:09:01	2.52	18.9
	18/10 21:10:01	2.33	18.71
	18/10 21:11:01	2.27	18.58
	18/10 21:12:01	2.33	18.46
	18/10 21:13:01	2.46	18.33
	18/10 21:14:01	2.71	18.2
	18/10 21:15:01	2.9	18.02
	18/10 21:16:01	2.96	17.89
	18/10 21:17:01	2.9	17.76
	18/10 21:18:01	2.71	17.64
	18/10 21:19:01	2.52	17.51
	18/10 21:20:01	2.27	17.39
	18/10 21:21:01	2.14	17.26
	18/10 21:22:01	2.14	17.13
	18/10 21:23:01	2.27	17.01
	18/10 21:24:01	2.46	16.88
	18/10 21:25:01	2.65	16.76
F	18/10 21:26:01	2.84	16.63